Highly precise／Clear data

[We have the software of the English version.]

印刷プレビュー
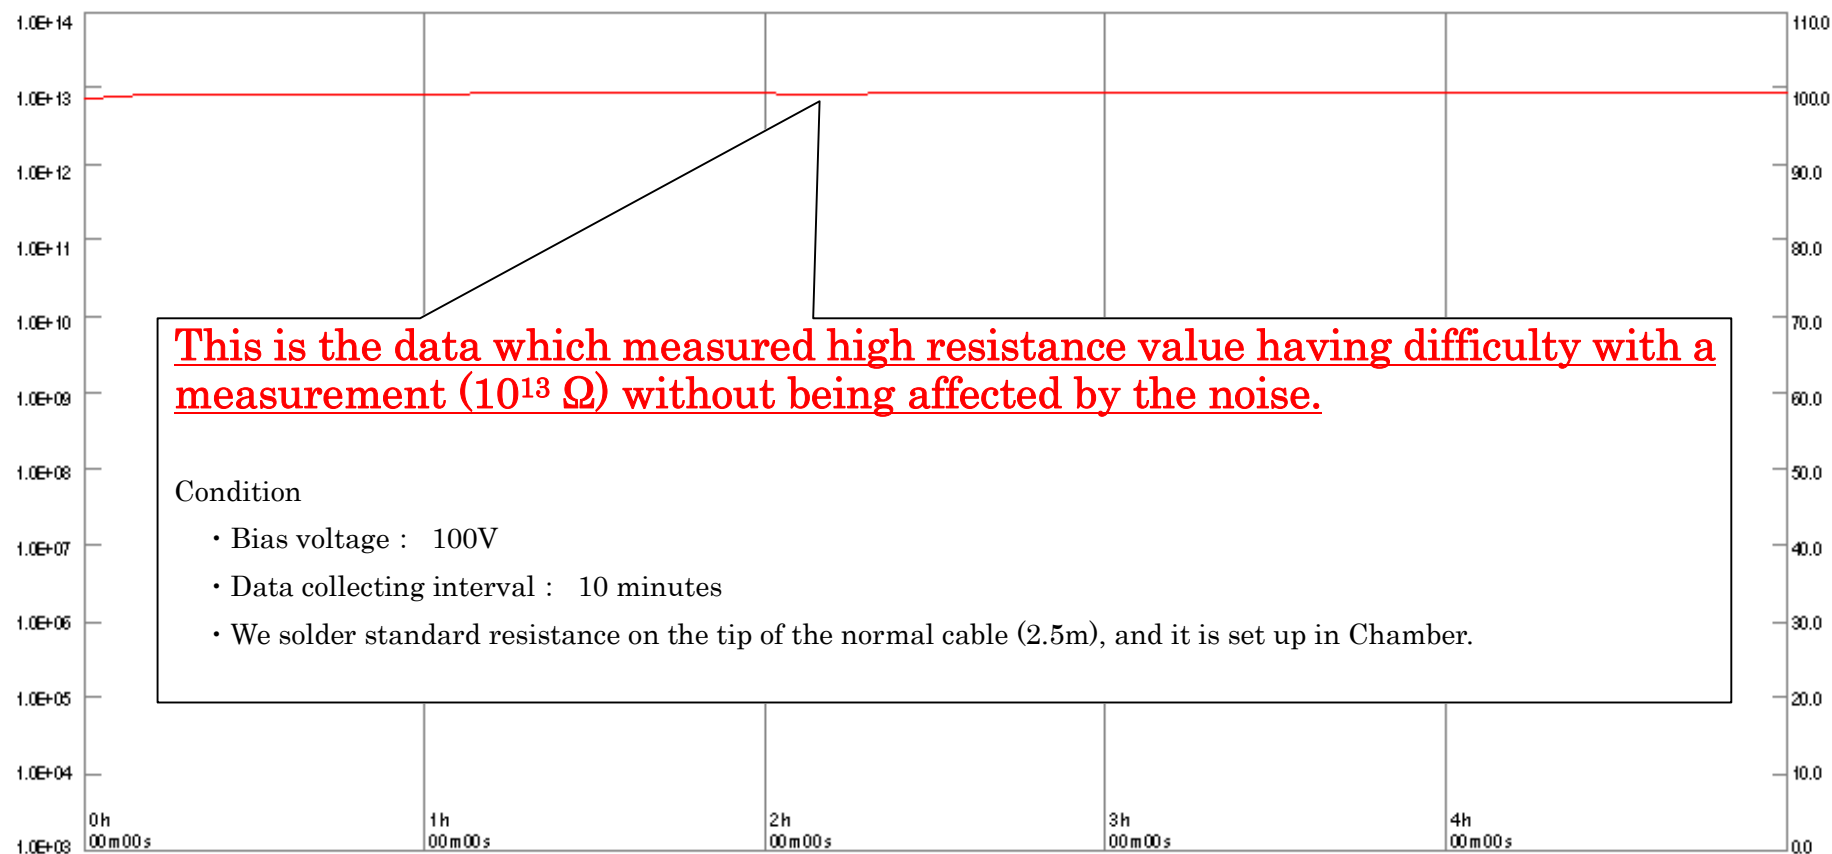
2008/06/05 16:15:42

エレクトロケミカルマイグレーション試験データ

CH1 :

ＤＣバイアス電圧	100.0 V
データ収録間隔	10 分
ECM判定閾値　レベル①	1.000E+006Ω
ECM判定閾値　レベル②	2.000E+006Ω

試験名称		10t		
メ　モ				
試験期間	開始	2008/06/05 10:53:29	終了（予定）	2008/06/05 20:53:29
試験時間	経過	5時間14分	合計	10時間0分

This is the data which measured high resistance value having difficulty with a measurement (10^{13} Ω) without being affected by the noise.

Condition
- ・Bias voltage :　100V
- ・Data collecting interval :　10 minutes
- ・We solder standard resistance on the tip of the normal cable (2.5m), and it is set up in Chamber.

1.0E+14 / 110.0
1.0E+13 / 100.0
1.0E+12 / 90.0
1.0E+11 / 80.0
1.0E+10 / 70.0
1.0E+09 / 60.0
1.0E+08 / 50.0
1.0E+07 / 40.0
1.0E+06 / 30.0
1.0E+05 / 20.0
1.0E+04 / 10.0
1.0E+03 / 0.0

0h 00m00s　1h 00m00s　2h 00m00s　3h 00m00s　4h 00m00s

□ 試験名称とメモを削除

プリント　　閉じる